

ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari
P.I. 00727270720

AREA GESTIONE TECNICA
AREA GESTIONE PATRIMONIO
DIRETTORE: ING. GIANCARLO SALOMONE

VERBALE DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, IN LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE, DELLA FORNITURA BIENNALE DI "SIRINGHE MONOUSO" (prot. n. 22149 del 2/12/2013).

Il giorno 12 del mese di DICEMBRE dell'anno 2013, alle ore 11:30, il Dirigente dell'Area Gestione Tecnica e del Patrimonio – Ing. Giancarlo Salomone, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, assistito dal Dott. Raffaele Quarato e dalla Sig.ra Anna Lisco, ha proceduto all'apertura on-line, delle offerte relative alla gara di cui al titolo.

Preliminarmente, si prende atto che, alle ore 14:00 del giorno 11/11/2013, termine fissato nella richiesta di preventivo (prot. PIO33806-13 del 3/12/2013) risultano pervenute le offerte delle seguenti Ditte (*riportate in ordine di arrivo*), invitate alla procedura di cui trattasi:

1. Benefis, Srl
2. Rays, SpA
3. Co.Di.San. Commercio Distribuzione Sanitari, SpA
4. B-Braun Milano, SpA
5. Chemil, Srl
6. Terumo Italia, Srl
7. Fase, Srl
8. Becton Dickinson Italia, SpA

Si procede, con l'apertura e la stampa delle offerte trasmesse dalle succitate Ditte, che vengono regolarmente vidimate dal Seggio di Gara ed infine esaminate:

Apertura della Documentazione Amministrativa:

La documentazione proposta dalle Ditte: Benefis Srl - Rays SpA - Co.Di.San. SpA - B-Braun SpA - Chemil Srl - Terumo Srl - Fase Srl - Becton Dickinson SpA, risulta completa. Di conseguenza, le Ditte sono ammesse alla fase successiva della gara.

Apertura delle Offerte Economiche:

No.	Ragione Sociale	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
1	BENEFIS Srl	€ 9.820,00	€ 2.058,00	€ 240,00	€ 1.764,00	
2	RAYS SpA	€ 11.320,00		€ 240,00	€ 1.702,40	
3	CO.DI.SAN.			€ 400,00	€ 2.800,00	
4	B-BRAUN MILANO SpA		€ 3.709,20	€ 500,00	€ 3.640,00	
5	CHEMIL SRL	€ 13.859,20			€ 2.506,00	
6	TERUMO ITALIA Srl			€ 716,00	€ 3.850,00	€ 670,00
7	FASE Srl	€ 14.923,60		€ 362,00	€ 2.604,00	€ 561,20
8	BECTON DICKINSON ITALIA Spa	€ 17.400,00	€ 2.746,00	€ 380,00	€ 2.660,00	€ 480,00



Dalla disamina delle offerte pervenute, risulta che, per quanto concerne il Lotto 3, le Ditte Benefis E Rays hanno offerto l'importo di € 240,00, quindi saranno invitate a formulare offerta migliorativa, ai sensi del R.D. 827/1924, art. 77.

Per quanto concerne gli altri lotti, il RUP decide di trasmettere, all'Area di Farmacia, le schede tecniche delle offerte risultate prime in graduatoria, così come di seguito riportato, per la verifica di conformità e di idoneità dei prodotti proposti:

Lotto 1: Ditta Benefis;


Lotto 2: Ditta Benefis;

Lotto 4: Ditta Rays;


Lotto 5: Ditta Becton Dickinson.

Il Presidente del Seggio dichiara conclusa la seduta di cui si redige il presente verbale, formato di n. 2 pagine, che letto ed approvato, viene sottoscritto alle ore 12:30.


Ing. Giancarlo Salomone



Dott. Raffaele Quarato



Sig.ra Anna Lisco



~~23 DIC. 2013~~

ARRIVO

Prot. n° 23450 del 23 DIC 2013

Direttore AGP
 Ing. G. Salomone
SEDE

OGGETTO : valutazione di conformità siringhe monouso

In riscontro alla nota prot. n. 23146 del 17/12/2013, si esprimono di seguito i giudizi di conformità in merito alle offerte formulate dalle ditte Benefis, Rays e BD:

lotto 1 Tipologie offerte dalla ditta Benefis		Codici	Conforme
voce 1	ml 5 (graduazione con incremento ogni 0,2 ml) cono luer centrale	50221500	Si
voce 2	ml 10 (graduazione con incremento ogni 0,5 ml) cono luer centrale	10211500	Si
voce 3	ml 20 (graduazione con incremento ogni 1 ml) cono luer centrale	20211500	Si

hys hys

Lotto 2 Tipologie offerte dalla ditta Benefis:		codici	Conformità
voce 1	ml 1 (graduazione con incremento ogni 0,01ml) cono luer-lock	01BLFPLL	Si
voce 2	ml 3 (graduazione con incremento ogni 0,1 ml) cono luer-lock	03BLFPLL	Si
voce 3	ml 5 (graduazione con incremento ogni 0,2 ml) cono luer-lock	05BLFPLL	Si
voce 4	ml 10 (graduazione con incremento ogni 0,5 ml) cono luer-lock	10BLFPLL	Si
voce 5	ml 20 (graduazione con incremento ogni 1 ml) cono luer-lock	20BLFPLL	Si
voce 6	ml 30 (graduazione con incremento ogni 1 ml) cono luer-lock	30BLFPLL	Si
Voce7	ml 50-60 (graduazione con incremento ogni 1 ml) cono luer-lock	60BLFPLL	Si

A

P.R.

13/10/2014
Almoro

Lotto 4 Tipologie offerte dalla ditta Rays:		codici	Conformità
Voce1	ml 50-60 (graduazione con incremento ogni 1 ml) cono catetere	60CC	Si



A


Lotto 5 Tipologie offerte dalla ditta BD:		Codici	Conformità
Voce 1	1 ml	301359	
Voce 2	0.5 ml non offerta		

Si precisa che il lotto 5 non è valutabile in quanto l'Azienda non ha offerto alcuna tipologia di siringa in relazione alla voce 2: siringhe da insulina da 0.5 ml.

Distinti saluti.

Il Direttore di Farmacia inc.

Patrizia NARDULLI



Prot. n° 30

del - 2 GEN 2014

Direttore AGP
Ing. G. Salomone
SEDE

OGGETTO : valutazione di conformità siringhe monouso. Lotto 3


In riscontro alla nota prot. n. 23573 del 23/12/2013, si esprime di seguito il giudizio di conformità in merito all'offerta formulata dalla ditta Benefis relativamente al lotto 3:

lotto 1	Tipologie offerte dalla ditta Benefis	Codici	Conforme
voce 1	Siringhe 50/60 ml da infusione ed irrigazione monouso con cono luer eccentrico a tre pezzi senza ago (graduazione con incremento ogni 1 ml)	60BLFL	Si

Distinti saluti.

Il Direttore di Farmacia inc.

Patrizia NARDULLI

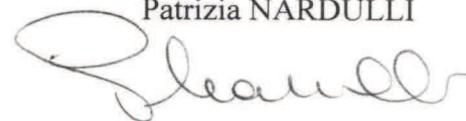

dr. Anselmo


l'ya lisc

h

P.R.

13/02/2014

Plumet

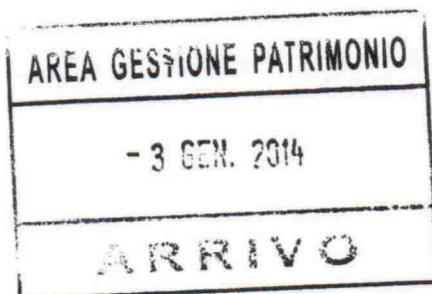

Prot. n° 282

del 9 GEN. 2014

Direttore AGP
Ing. G. Salomone
SEDE


OGGETTO : valutazione di conformità siringhe monouso - precisazioni

In riferimento alle comunicazioni prot. n. 23450 del 26/12/2013 e n. 30 del 02/01/2014, si precisa che le tipologie di siringhe offerte dalla ditta Benefis (lotti 1, 2 e 3) e dalla ditta Rays (lotto 4) sono idonee e conformi a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Distinti saluti.

Il Direttore di Farmacia inc.

Patrizia NARDULLI

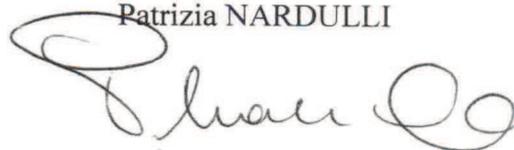



dr. Quaresima

ha liscio

f

P.R.

13/01/2014

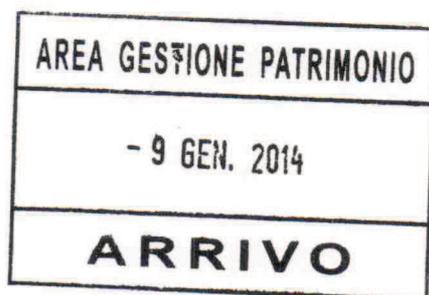

Prot. n° 857

del 20 GEN. 2014



Direttore AGP
Ing. G. Salomone
S E D E

OGGETTO : valutazione di conformità ed idoneità siringhe monouso. Lotto 5



In riscontro alla nota prot. n. 839 del 17/01/2014, si esprime di seguito il giudizio di conformità ed idoneità in merito all'offerta della ditta FASE relativamente al lotto 5:

lotto 5	Tipologie richieste	Commenti	Conforme/idoneo
Voce 1	Siringa sterile, apirogena, atossica, pronta all'uso con ago indolore non saldato 25G da 1 ml – 100 U. Latex free. Ago non saldato	L'articolo campionato non corrisponde a quello richiesto. Infatti si tratta di siringa con ago 27G	Non valutabile
Voce 2	Siringa sterile, apirogena, atossica, pronta all'uso con ago indolore non saldato 25G da 0.5 ml – 100 U. Latex free. Ago non saldato	L'articolo campionato non corrisponde a quello richiesto. Offrono in visione siringa con ago saldato 29 G	Non valutabile

Si evidenzia inoltre che la dichiarazione relativa all'assenza di lattice ed al grado di siliconatura non è considerata probante ed attuale dalla scrivente UO di Farmacia, in quanto le certificazioni relative alla dichiarazione "latex free" possono essere sostituite da una attestazione, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, solo se rese dal Rappresentante Legale o dal Direttore Tecnico Responsabile o dal Direttore del Controllo di Qualità Interno del Processo Produttivo.

Il Direttore di Farmacia inc.

Patrizia NARDULLI





Prot. n° 1535

del 29 GEN. 2014

Direttore AGP
Ing. G. Salomone

SEDE

OGGETTO : valutazione di conformità ed idoneità siringhe monouso. Lotto 5

In riscontro alla nota prot. n. 1290 del 24/01/2014, si esprime di seguito il giudizio di conformità ed idoneità in merito all'offerta della ditta TERUMO ITALIA relativamente al lotto 5:

lotto 5	Tipologie offerte	Commenti	Conforme/idoneo
Voce 1	Siringa da insulina a tre pezzi da 100 UI- 1ml. Ago 25 G Cod. SS01H25161	Impossibile verificare che il grado di siliconatura non superi 0.25 mg/cm ² , sebbene sia dichiarato in scheda tecnica che tra i test strutturali è stato fatto anche quello per la quantità di lubrificante.	Non valutabile
Voce 2	Siringa da insulina da 0.5 ml con ago saldato Cod. GF0837	Impossibile verificare che il grado di siliconatura non superi 0.25 mg/cm ² , sebbene sia dichiarato in scheda tecnica che tra i test strutturali è stato fatto anche quello per la quantità di lubrificante. Richiesto ago non saldato	Non valutabile

Cordialmente.

Il Direttore di Farmacia inc.

Patrizia NARDULLI

